
はじめにお読みください


1 CD を挿入して、**ソフトウェアをインストール**を選択します。



2 **プラグアンドプレイインタフェース**を選択して、**次へ**をクリックします。

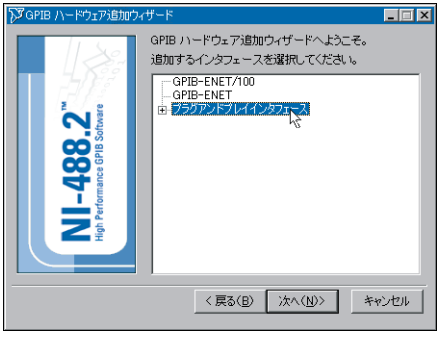

3 **再起動**を選択して、**完了**をクリックします。

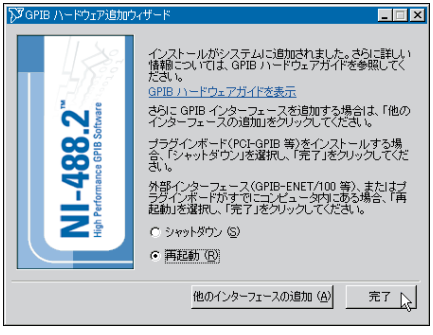


(手順 4 へ続く)

4 ハードウェアをインストールします (注)。



5 NI-488.2 クイックスタートウィザードを実行します。

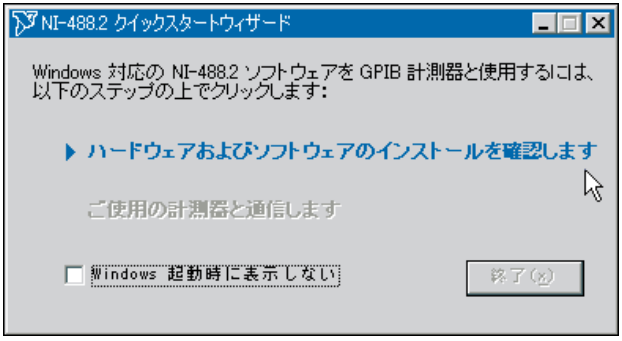

(注) ハードウェアのインストール方法については、『GPIBハードウェアガイド』を参照してください（CDの「ドキュメントを表示」からご利用いただけます）。

© 1999–2003 National Instruments Corporation. All rights reserved.

National Instruments™、ni.com™、NI-488.2™ は National Instruments Corporation の商標です。記載されている製品名および会社名は、該当各社の商標または商号です。

National Instrumentsの製品を保護する特許については、「ヘルプ」→「特許」を選択すると表示される製品情報（該当する場合）、このCDにある patents.txt ファイル（該当する場合）および/または ni.com/patents を参照してください。

322483B-01 0203